

Saint-Cloud, le 05 Juillet 2022.

**Objet : Arrêt de références gamme Monoplus®**

Madame, Monsieur,

Dès le 09 juillet 2022, nous effectuerons notre première transition du MDD au MDR pour notre gamme MONOPLUS®.


Comment ce processus de transition va-t-il se dérouler ?

Le marquage CE MDD pour Monoplus® expire le 9 juillet 2022. Cela signifie que, le 9 juillet 2022, les produits quittant nos locaux seront conformes aux nouvelles exigences du MDR.

Les produits fabriqués sous MDR présentent certaines différences par rapport aux produits que nous avons fabriqués sous MDD.


A savoir :

a. Etiquetage des sutures

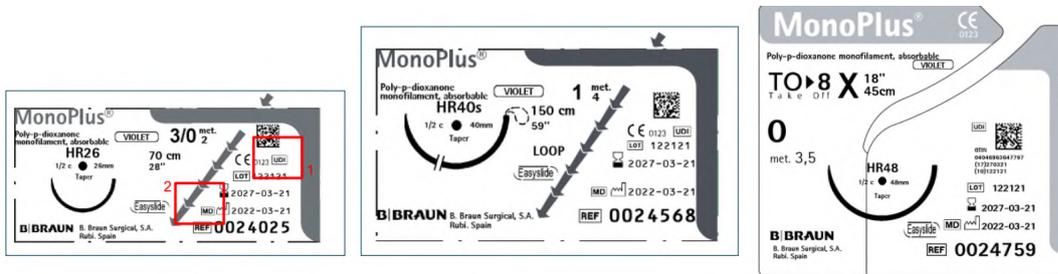

1. Code UDI : Unique Device Identification
2. Produit fabriqué sous la réglementation MDR
3. Symboles afin de décrire le type de suture (monofilament/tressé ; résorbable / non résorbable) ainsi que la composition (PDO, PGLA, etc.).

b. Étiquetage des boîtes

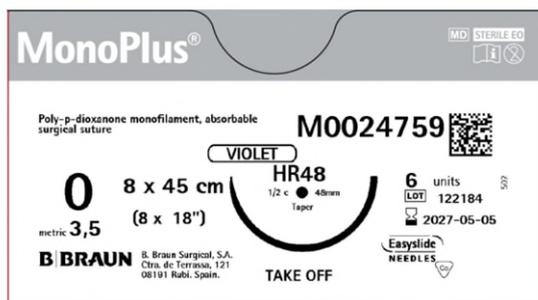

c. Nouvelle notice d'utilisation

Cette nouvelle réglementation MDR nous oblige, également, à rationaliser nos gammes. C'est pourquoi, nous sommes au regret de vous informer de l'arrêt de la commercialisation des références ci-dessous.

Référence	Désignation
C0024180	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M)DDP
C0024240	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)40 GR19 LOP (M) DDP
C0024241	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM GR19 LOP (M) DDP
C0024532	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR18 (M) DDP
C0024646	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR37 (M) DDP
C0024649	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)120CM SKR26 (M) DDP
C0024650	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)40 SKR26LOP (M) DDP
C0024995	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 45CM 2XGS45 (M) DDP

Ci-dessous le tableau des codes équivalents :

Référence arrêtée	Référence équivalente	Désignation
C0024180	Pas d'équivalence	
C0024240	C0024247	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)30CM GR19(M)
C0024241	C0024245	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)30CM GR19(M)
C0024532	C0024533	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
C0024646	Pas d'équivalence	
C0024649	C0024664	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM SKR26 (M)
C0024650	C0024606	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM SKR26 LOP
C0024995	C0024994	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM 2XGS45(M)

Pendant cette phase de transition, les délais d'approvisionnement peuvent être rallongés sur certaines de vos commandes.

Nous avons conscience de l'impact que cela peut avoir sur votre activité et nous nous excusons par avance pour les gênes occasionnées.

Soyez toutefois assuré que nous mettons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction.

Les modalités de gestion des commandes restent, par ailleurs, inchangées.

Vous pouvez joindre, à tout moment, notre service client, ouvert de 8h30 à 17h30, au 01 41 10 53 00 (puis tapez 112) pour le suivi de vos commandes, la gestion des réclamations et vous pouvez envoyer vos commandes par fax au 01 41 10 52 04 ou par mail : [pole-commandes.fr@bbraun.com](mailto:pole-commandes.fr@bbraun.com)

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout complément d'informations. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Johanna MULTON  
Chef de produit Closure Technologies  
07 88 30 89 17

